



確認シール変更等のご案内

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

ロタリックス®内用液

このたび、上記製品につきまして、確認シールのデザイン等を変更いたしますので、下記のとおりご案内申し上げます。

2017年6月

記

対象製品

ロタリックス内用液 1チューブ1回分1.5mL:1本

変更内容


【確認シールの変更点】

- 最終有効年月日を追加表示いたします。
- デザインを変更いたします。確認シールのサイズは変更ありません。

【製造番号の変更点】

- 10桁から5桁へ変更いたします。(例:AROLB478BA→RT001)

これに伴い、捺印面に記載の製造番号および確認シール記載の製造番号を変更いたします。

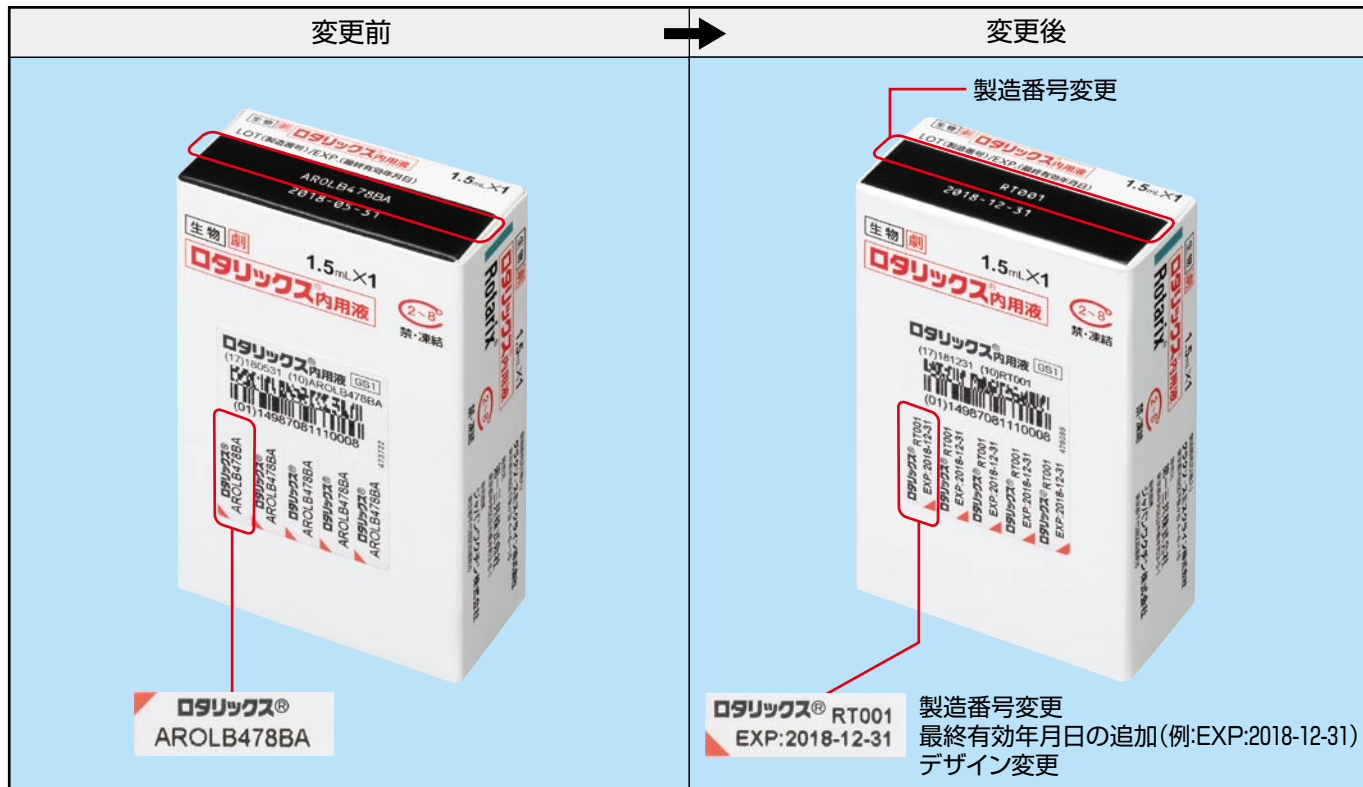

裏面もご覧ください。▶▶▶▶



製造販売元(輸入)
グラクソ・スミスクライン株式会社
 〒151-8566 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15 GSKビル
<http://jp.gsk.com>



販売元
第一三共株式会社
 東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携
ジャパンワクチン株式会社
 東京都千代田区四番町6

変更品の識別方法

変更に伴う個装箱および梱包箱への表示はいたしませんのでご了承ください。

変更品の出荷予定時期、製造番号

品名	包装	統一商品コード	出荷予定時期	製造番号
ロタリックス内用液	1チューブ1回分1.5mL:1本	081-110001	7月	RT001

※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後する場合がありますが、ご了承ください。

以上